

Concise Explanation of Japanese Reference

Published Unexamined Japanese Patent Application: JP-A S63-19149

Title of the Invention: Medical Container and Production Method thereof

The invention claimed in this patent application particularly relates to a medical container that can separately contain, in different compartments, a plurality of components of intravenous hyperalimentation or elemental diet which components are highly reactive with each other, and a method for producing such container.

The container can enclose each of a plurality of solutions and composed of multilayer plastic sheet having at least inner and outer layers. Part of the inner layers is bonded to each other to form a plurality of compartments, into each of which different solution is enclosed. The bonded portions are broken up before use and the solutions are mixed together in the container.

The invention also provides a method for producing such medical container, which comprises forming a container of multilayer plastic sheet, retaining the bonded state between the inner layers in the atmosphere at the temperature at which the inner layers are bonded, and providing a plurality of compartments in the container.

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭63-19149

⑬ Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和63年(1988)1月26日

A 61 J 1/00
B 65 D 81/32

3 5 1

7132-4C
C-2119-3E

審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

⑮ 発明の名称 医療用容器及びその製造方法

⑯ 特 願 昭61-162222

⑰ 出 願 昭61(1986)7月10日

⑱ 発 明 者 鈴木 龍 夫 東京都町田市小山田桜台1丁目5番地27-302

⑲ 発 明 者 磯野 啓 之 介 埼玉県川口市大字安行藤八46番地112

⑳ 出 願 人 磯野 啓 之 介 埼玉県川口市大字安行藤八46番地112

明 細 書

1. 発明の名称

医療用容器及びその製造方法

2. 特許請求の範囲

- (1) 複数の薬液をそれぞれ隔離して封入することができる容器であって、前記容器は少なくとも内層と外層を有する合成樹脂製多層シートで構成され、前記内層の一部を接合して複数の室が形成され、それぞれの室に異なる薬液が封入され、使用時に前記接合部を分離し前記薬液を前記容器内で混合することができることを特徴とする薬液入り医療用容器。
- (2) 前記内層の引張強度が前記外層よりも小さいことを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の医療用容器。
- (3) 前記外層の肉厚が前記内層の肉厚の2倍以上である特許請求の範囲第1項または第2項に記載の医療用容器。
- (4) 合成樹脂製多層シートで容器を形成し、内層

相互が接合する温度の雰囲気中でその容器の一部を軟弱体で密着させた状態を保持して接合させ、前記容器に複数の室を作ることとを特徴とする医療用容器の製造方法。

(5) 前記合成樹脂製多層シートの内層の引張強度が外層よりも小さいことを特徴とする特許請求の範囲第4項記載の医療用容器の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、医療用容器及びその製造方法に関する。特に、クローズド医療システムに用いられる高カロリー輸液剤やエレメンタルダイエット(以下EDと略す)の成分で互いに反応しやすい成分を複数種入れることのできる液れ得る薬液入り医療用容器及びその製造方法に関する。

〔従来の技術〕

近年生体に必要な栄養素すべてを経腸管より摂取する高カロリー輸液法がさかんに行われるようになってきた。高カロリー輸液法が適用されるのは、消化管吻合不全、消化管通過障害等の経口経

特開2003-19149(2)

取が不十分または不可能な場合、炎症性腸疾患、重症下痢等の経口摂取が好ましくない場合、広範熱傷、多発重症外傷等の経腸補給を上回る高カロリー補給が望まれる場合、肝不全・腎臓不全、糖尿病等の疾患による代謝の特異性を応用する場合などである。

高カロリー輸液法に用いられる高カロリー輸液剤は生体に必要な栄養素をすべて適量含むことが基本である。すなわち、糖質、アミノ酸、主要電解質、微量金属及びビタミンを含む多成分輸液剤になる。しかし、これらのすべてを含む複合液を製品化することは配合性、安定性の面で現在は不可能である。そこで、現在三つの方法が用いられている。

①市販の高カロリー輸液用基本液を用いる。高温滅菌ブドウ糖液に主要電解質が配合された液で、使用時アミノ酸を混合し、ビタミン及び不足な電解質を添加する。

②市販の高張ブドウ糖液とアミノ酸液を混合又は両方を過熱して投与する。

- 3 -

本発明は、複数の薬液をそれぞれ隔離して封入することができる容器であって、前記容器は少なくとも内層と外層を有する合成樹脂製多層シートで構成され、前記内層の一部を接着して複数の室が形成され、それぞれの室に異なる薬液が封入され、使用時に前記接合部を剥離し前記薬液を前記容器内で混合することができる医療用容器を提供することにある。

また本発明は、合成樹脂製多層シートで容器を形成し、内層相互が接着する温度の雰囲気中でその容器の一部を支持体により密着させた状態を保持して接着させ、前記容器に複数の室を作ることと特徴とする医療用容器の製造方法を提供することにある。

【作用】

前述したように、互いに反応する成分を含む薬液を一液調剤にしておくと、滅菌時及び長期保存時に薬液が変色或は変質してしまうので、使用時に混合する必要がある。この混合時に調剤ミスや汚染等の問題が発生していた。かかる問題を解決

- 5 -

③高カロリー輸液基本液又はブドウ糖液を独自に薬局製剤室で作成する。

いずれにしても、高カロリー輸液用基本液又は高張ブドウ糖液にアミノ酸液を使用時に混合して患者に投与するわけである。

【発明が解決しようとする問題点】

従来ブドウ糖アミノ酸を配合して一液調剤とし容器に封入すると、高温滅菌時及び保存時にブドウ糖とアミノ酸との間で反応が起こり輸液剤が着色していた。このため、上述したように現在のところブドウ糖とアミノ酸のように互いに反応しやすい成分を含む薬液を混合して一液調剤とすることができず、これらの薬液を使用時に混合して患者に投与していた。このように、使用時に混合するという操作は、調剤ミスを起こす可能性があり、また混合時の汚染等の問題がある。

本発明は、互いに反応しやすい成分を含む薬液を安定した状態で滅菌及び長期保存できる医療用容器及びその製造方法を提供することにある。

【問題点を解決するための手段】

- 4 -

するためには、複数の室を有する容器を形成し、それぞれの室に互いに反応しやすい成分を含む薬液を隔離して所定量を封入しておき、使用時にこれらの複数の室を互いに連通させて容器内で前記薬液を混合することにより上記問題点を解決することができる。

容器を多層シートで作製し、容器の一部を接着して複数の室を形成する。容器を多層シートで構成することにより、この接合部に剥離させる方向に力を加えると、外層を破壊することなく接着している内層を破壊して各室を連通させることができることを見出した。さらに、内層の引張強度を外層より小さくすることにより、また外層の肉厚を内層の肉厚の2倍以上にすることにより、一層確実に外層を破壊することなく接着している内層を破壊できることを見出した。

また、容器部を複数の室に分けるための接合部を形成するとき、内層相互が接着する温度の雰囲気中でその容器の一部を支持体により密着させた状態を保持して接着させることにより、外層を破

- 6 -

特開2003-19149(3)

壊することなく接着している内層を破壊することができることを見出した。

【実施例】

次に、本発明を図面に基づいて具体的に説明する。

本発明の医療用容器の一例を第1図及び第2図に示す。医療用容器1の容器部2は、その外層7が合成樹脂で形成され、その内層8には外層7よりも引張強度の小さい合成樹脂で形成されている多層構造のインフレーション成形によって得たチューブ状のシートの両端開放を熱溶着し、更に容器部の一部12を接着することによって得たものである。また、排出口部3は、その内層9が合成樹脂で形成され、その外層10には容器部2の外層7および排出口部3の内層9よりも低い融点を有する合成樹脂が被覆されている。一方の融着端部4には、医療用容器1を密封するための融着口5及び薬液注入口11が設けられ、他方の融着端部6には、排出口部3が挿入溶着されている。融着端部6に排出口部3を熱溶着するとき、排出口部3の外層10

が内層9及び容器部2の内層8と外層7よりも融点が低いので、外部よりの加熱により内層9が先に溶融し、容器部2と排出口部3は、容易にかつ確実に溶着することができる。

さらに第3図に示すように、排出口部3は、その外層10にはリング状等の突起部11を有することが好ましい。すなわち、融着端部6に排出口部3を挿入溶着するとき、より確実に確実に溶着することができるからである。

容器部2の外層7としては、直鎖状低密度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、塩素化ポリエチレン、ポリプロピレン、オレフィン系エラストマー、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリウレタン系樹脂等を用いることができる。好ましくは、柔軟性に優れた被覆強度の大きな直鎖状低密度ポリエチレンを用いるのが好ましい。また容器部2の内層8としては、外層7よりも引張強度の小さい低密度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、直鎖状低密度ポリエチレン、エチレン-酢酸ビニル共重合体、軟質ポリ塩化ビ

- 7 -

- 8 -

ニル樹脂等を用いることができる。ただし、外層7との組み合わせを考慮する必要がある。

これらの多層シートの厚みは、0.1～0.5mm好ましくは0.2～0.4mmとすることができる。0.1mm以下であると被覆強度が悪くなり破壊の危険性が增大する。また、0.5mm以上であると柔軟性と透明性が悪くなる。また、容器部2の外層7と内層8の接着性が悪いときには、外層7と内層8の間に中間層として接着層を有する多層シートを用いることもできる。

排出口部3は二色成形法にて作製することができる。排出口部3の内層9には、直鎖状低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂等を用いることができる。排出口部3の外層10は、低密度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、直鎖状低密度ポリエチレン、エチレン-酢酸ビニル共重合体等を用いることができる。さらに、排出口部3の外層10は、容器部2の内層8と同じ合成樹脂を用いることにより、容器部2と排出口部3を容

易にまた確実に熱溶着することができる。

また、排出口部3の内層9と外層10の接着性が悪いとき等には、内層9と外層10の間に中間層として接着層を有する三色成形により、排出口部3を作製することが好ましい。

また本発明の医療用容器は、上述の合成樹脂の押出成形によって得られた多層ラミネートシート二枚を重ね合わせ、その周縁部を熱溶着することによって得ることができる。

このようにして得られた容器は、第4図に示すように、容器部2の一部12を両側から金属やセラミックスや合成樹脂等で作製された挟持体13で挟持して内層を互いに密着させ、室21と室22に隔離される。次に、排出口部3と薬液注入口11より、互いに反応する成分を含む薬液をそれぞれの室21、22に分離して注入し、排出口部3と薬液注入口11を封入する。挟持体13により室21および室22内の両薬液が混合しないようにしたままで高圧蒸気滅菌する。この滅菌時の加熱により、挟持体13で挟持されていた部分は接着されるので、滅菌後に挟

- 9 -

- 10 -

特開2003-13149(4)

保持体13を取り除いても接着部12の内面相互は接着されており、室21と室22の高液はそれぞれ隔離された状態を保つことができる。また、容器の一部12を保持体13で挟持し全体を加温して接着させてから、高液を注入することもできる。

この高液入り容器は、使用時に室21と室22に封入されている高液を混合して使用される。容器部の両面を保持し、接着部12を剥離する方向（第2図のA方向）に引っ張り室21と室22を連通させ、それぞれの高液を容器部2内で混合する。次に、排出口部3に換液セットのピン針を挿入し、通常の換液手技に基づいて患者に高液を投与する。

接着部12の剥離を更に容易にするためには、接着部12を変曲点を有する曲線あるいは屈曲部を有する線分（この屈曲部も変曲点の近端に入れる）で構成される形状にするのが好ましい。例えば、接着部を第4図に示すような一個の変曲点14（屈曲部）を有するV字状にすることにより、容器部の中央部を保持し接着部を剥離する方向に引っ張れば変曲点14から容易に接着部を剥離することが

できる。更に、接着部を第5図、第6図に示すような形状125、126にすることができる。（変曲点を有する曲線で構成される接着部は図示せず）

また、第6図に示すように、室621、室622、室623と三室を有する容器を作製することもできる。

また、隔離されている各室に、凍結乾燥されたED粉末と滅菌水、あるいは抗生物質の粉末と生理食塩水を封入することもできる。

実施例1

直線状低密度ポリエチレン（商品名：ニボロン-L、東洋曹達工業特製、密度：0.925 g/cm³）と低密度ポリエチレン（商品名：ペトロセン、東洋曹達工業特製、密度：0.917 g/cm³）を用いて、低密度ポリエチレンが内層になるように共押出成形によるインフレーションチューブを作製した。外側の直線状低密度ポリエチレンの層の厚みは250 μm内側の低密度ポリエチレンの層の厚みは50 μmであった。また、排出口部と薬液注入口を高密度ポリエチレン（商品名：ニボロンハード、

- 11 -

- 12 -

東洋曹達工業特製、密度：0.960 g/cm³）と低密度ポリエチレン（商品名：ペトロセン、東洋曹達工業特製、密度：0.917 g/cm³）を用いて二色成形により作製した。排出口部及び薬液注入口の外側の低密度ポリエチレンの層の厚みは50 μmであった。次に、インフレーションチューブの一方の端部を二色成形により作製した薬液注入口を挿入溶着し、さらに懸垂口を設けた。他方の端部は、二色成形により作製した排出口部を挿入溶着し、容器を作製した。

この容器の中央近傍部位をV字状の保持体で挟持し容器部を二室に分け、薬液注入口よりブドウ糖を注入し薬液注入口を封入した。次に、排出口部よりアミノ酸液を注入し排出口部を封入した。

この高液入り容器を保持体で保持したまま、

110℃で60分間高圧蒸気滅菌した。滅菌後、薬液入り容器から保持体を取り除き、この高液入り容器を激しく振動させたが、容器内のブドウ糖液とアミノ酸液は混合されなかった。

次に、この高液入り容器の接着部近傍の容器部

を保持し、接着部を剥離させる方向に引っ張ると接着部は剥離し、容器内のブドウ糖液とアミノ酸液が混合された。

比較例1

直線状低密度ポリエチレン（商品名：ニボロン-L、東洋曹達工業特製、密度：0.925 g/cm³）を用いて、インフレーションチューブを作製した。このインフレーションチューブの厚みは300 μmであった。また、排出口部と薬液注入口を高密度ポリエチレン（商品名：ニボロンハード、東洋曹達工業特製、密度：0.960 g/cm³）と低密度ポリエチレン（商品名：ペトロセン、東洋曹達工業特製、密度：0.917 g/cm³）を用いて二色成形により作製した。排出口部及び薬液注入口の外側の低密度ポリエチレンの層の厚みは50 μmであった。次に、インフレーションチューブの一方の端部を二色成形により作製した薬液注入口を挿入溶着し、さらに懸垂口を設けた。他方の端部は、二色成形により作製した排出口部を挿入溶着し、更に容器部の中央をヒートシールにより溶着して二

- 13 -

- 14 -

特開2003-18149(5)

高を有する容器を作製した。

この容器の蓋被注入口よりブドウ糖を注入し蓋被注入口を封入した。次に、排出口部よりアミノ酸液を注入し排出口部を封入した。

この薬液入り容器を 110℃で 60 分間高圧蒸気滅菌した。

次に、この薬液入り容器の中央の接着部近傍の容器壁を保持し、接着部を剥離させる方向に引っ張ると接着部は破壊され、容器内のブドウ糖液とアミノ酸液は容器より流出した。

〔発明の効果〕

以上述べたように、本発明の医療用容器は以下に示す利点を有する。

①互いに反応しやすい成分を含む薬液を一つの容器に分離して保存でき、使用時に容易にその容器内で混合できるので調剤ミスや汚染の危険性がない。

②容器部の内層は、その外層より引張強度が小さいので、容器部を破壊することなく接着部を剥離できる。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は本発明の医療用容器の第一実施例を示す正面図、第 2 図は同実施例のⅡ-Ⅱの縦断面図、第 3 図は排出口部の他の実施例を示す部分断面図、第 4 図は第一実施例の接着部を作製する方法を示す斜視図、第 5 図は本発明の第二実施例を示す正面図、第 6 図は本発明の第三実施例を示す正面図である。


1…医療用容器、 2…容器部、 3…排出口部
4…蓋被注入部、 5…蓋垂口、 6…蓋被注入部
7…容器部の外層、 8…容器部の内層
9…排出口部の内層、 10…排出口部の外層
11、11'…薬液注入口、 12…挟持体
13、125、126…接着部、 14…突出点
21、22、621、622、623…室
33…排出口部、 39…排出口部の内層
40…排出口部の外層、 41…突起部
A…接着部を剥離する方向

特許出願人 種野啓之介

- 15 -


- 16 -

第 1 図

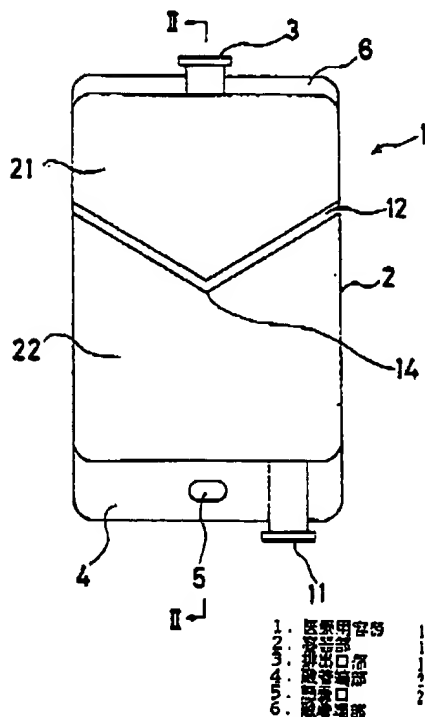

1. 医療用容器
2. 容器部
3. 排出口部
4. 蓋被注入部
5. 蓋垂口
6. 蓋被注入部
11. 薬液注入口
12. 挟持体
13. 接着部
14. 突出点
21. 室
22. 室


第 2 図

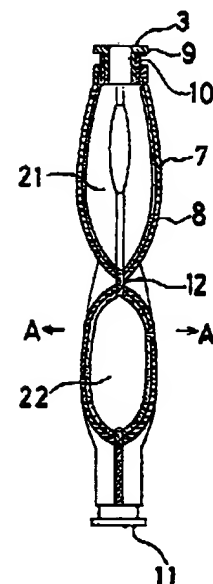


3. 排出口部
7. 容器部の外層
8. 容器部の内層
9. 排出口部の内層
10. 排出口部の外層
11. 薬液注入口
12. 挟持体
21. 室
22. 室
A. 接着部を剥離する方向

特開昭63-19149(6)

第4図

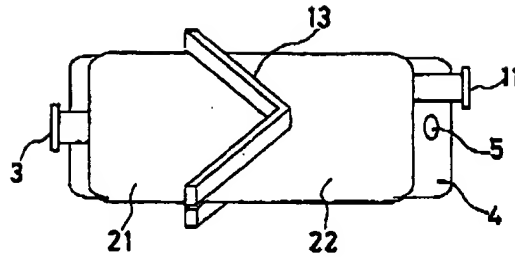


第3図




- 3. 排出口部
- 4. 融着部
- 5. 圧力口
- 11. 液体注入口
- 13. 楔状体
- 21. 室
- 22. 室
- 33. 排出口部
- 39. 排出口部の内層
- 40. 排出口部の外層
- 41. 突起部

第5図

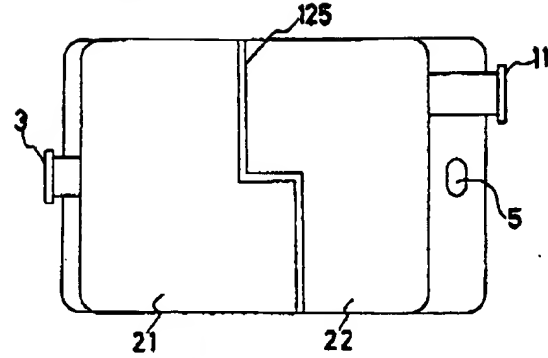

第6図

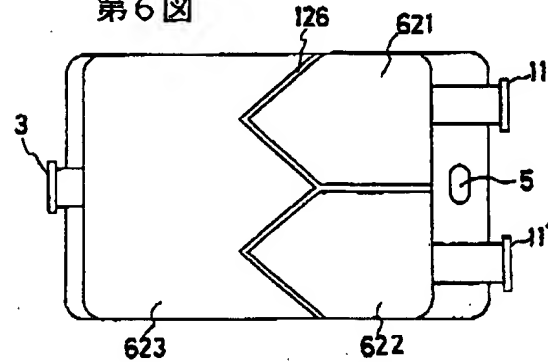

- 3. 排出口部
- 5. 圧力口
- 11, 11'. 液体注入口
- 125, 126. 楔状部
- 21, 22, 621, 622, 623. 室